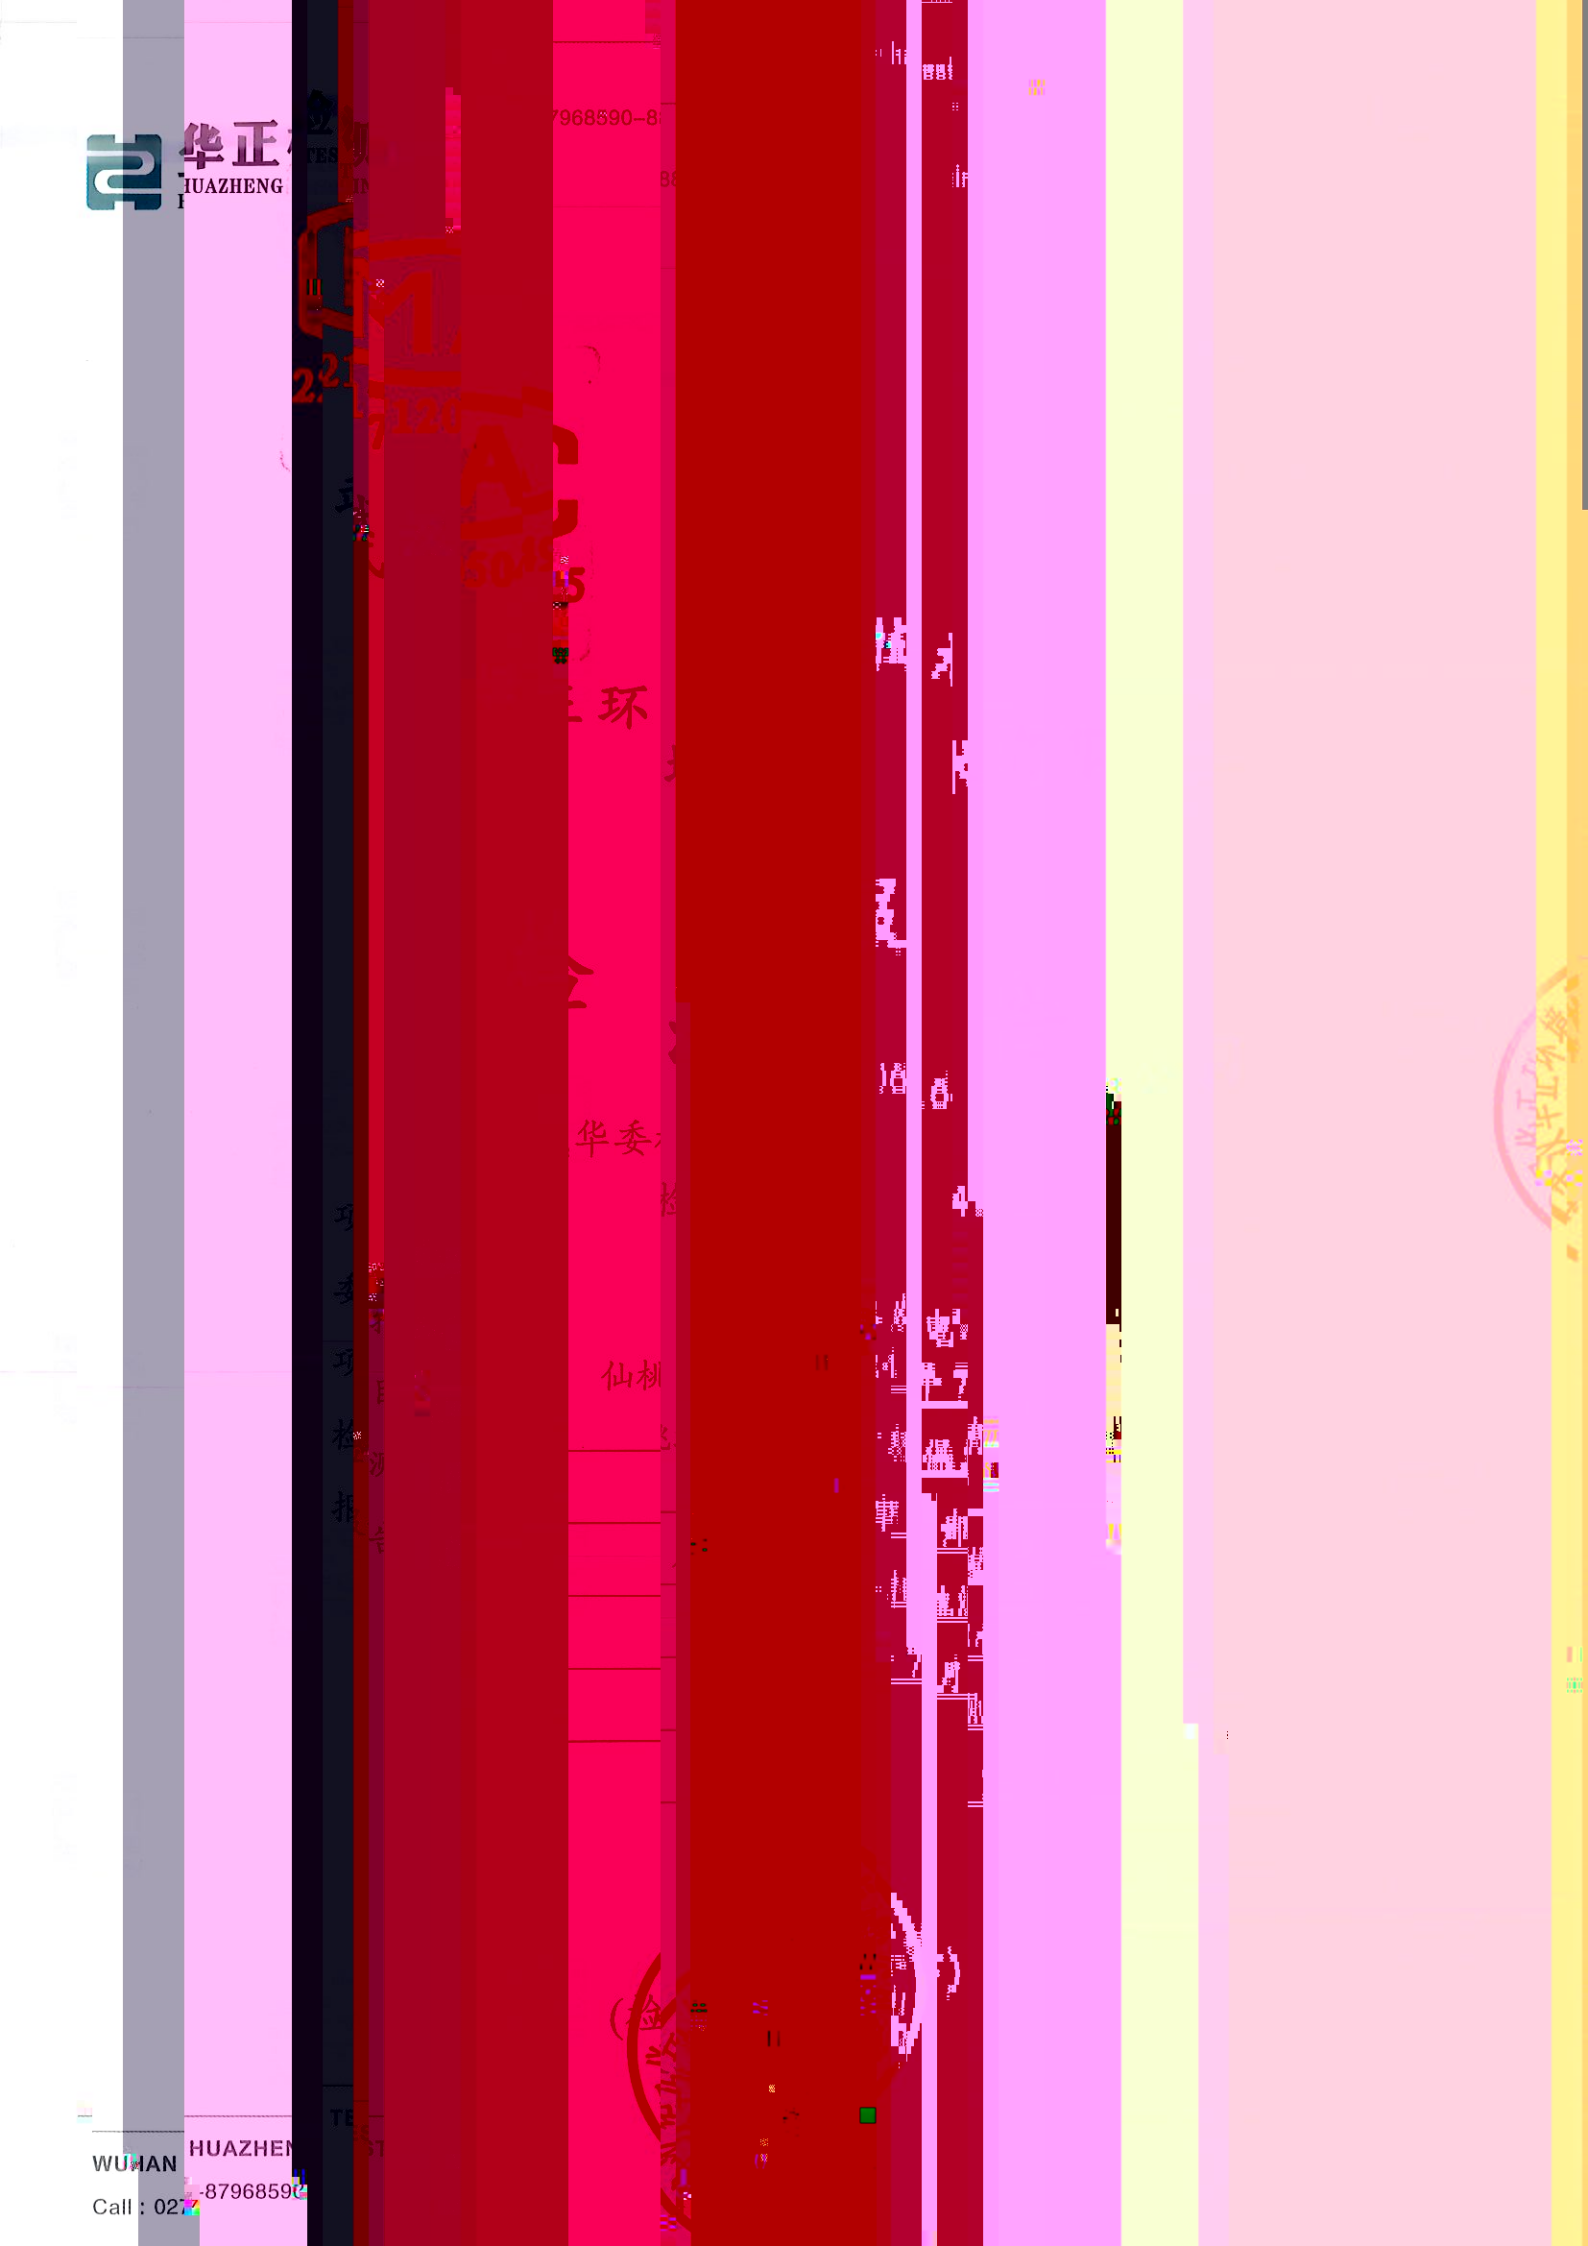


一、报告专用章（红色检测报告专用）无效，未加盖；


二、报告无骑缝章，未加盖本报告骑缝章的报告无效；

三、委托样品，不负责样品的检测结果；

四、未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）报告；


五、对报告形式或内容有异议的，请于收到报告之日起十个工作日内向本公司提出，逾期视为无异议。


检测项目检测实验室：
☑武汉实验室：武汉东湖高新技术开发区高新四路40号葛洲坝太阳城3栋4栋5栋
□宜昌实验室：
□襄阳实验室：

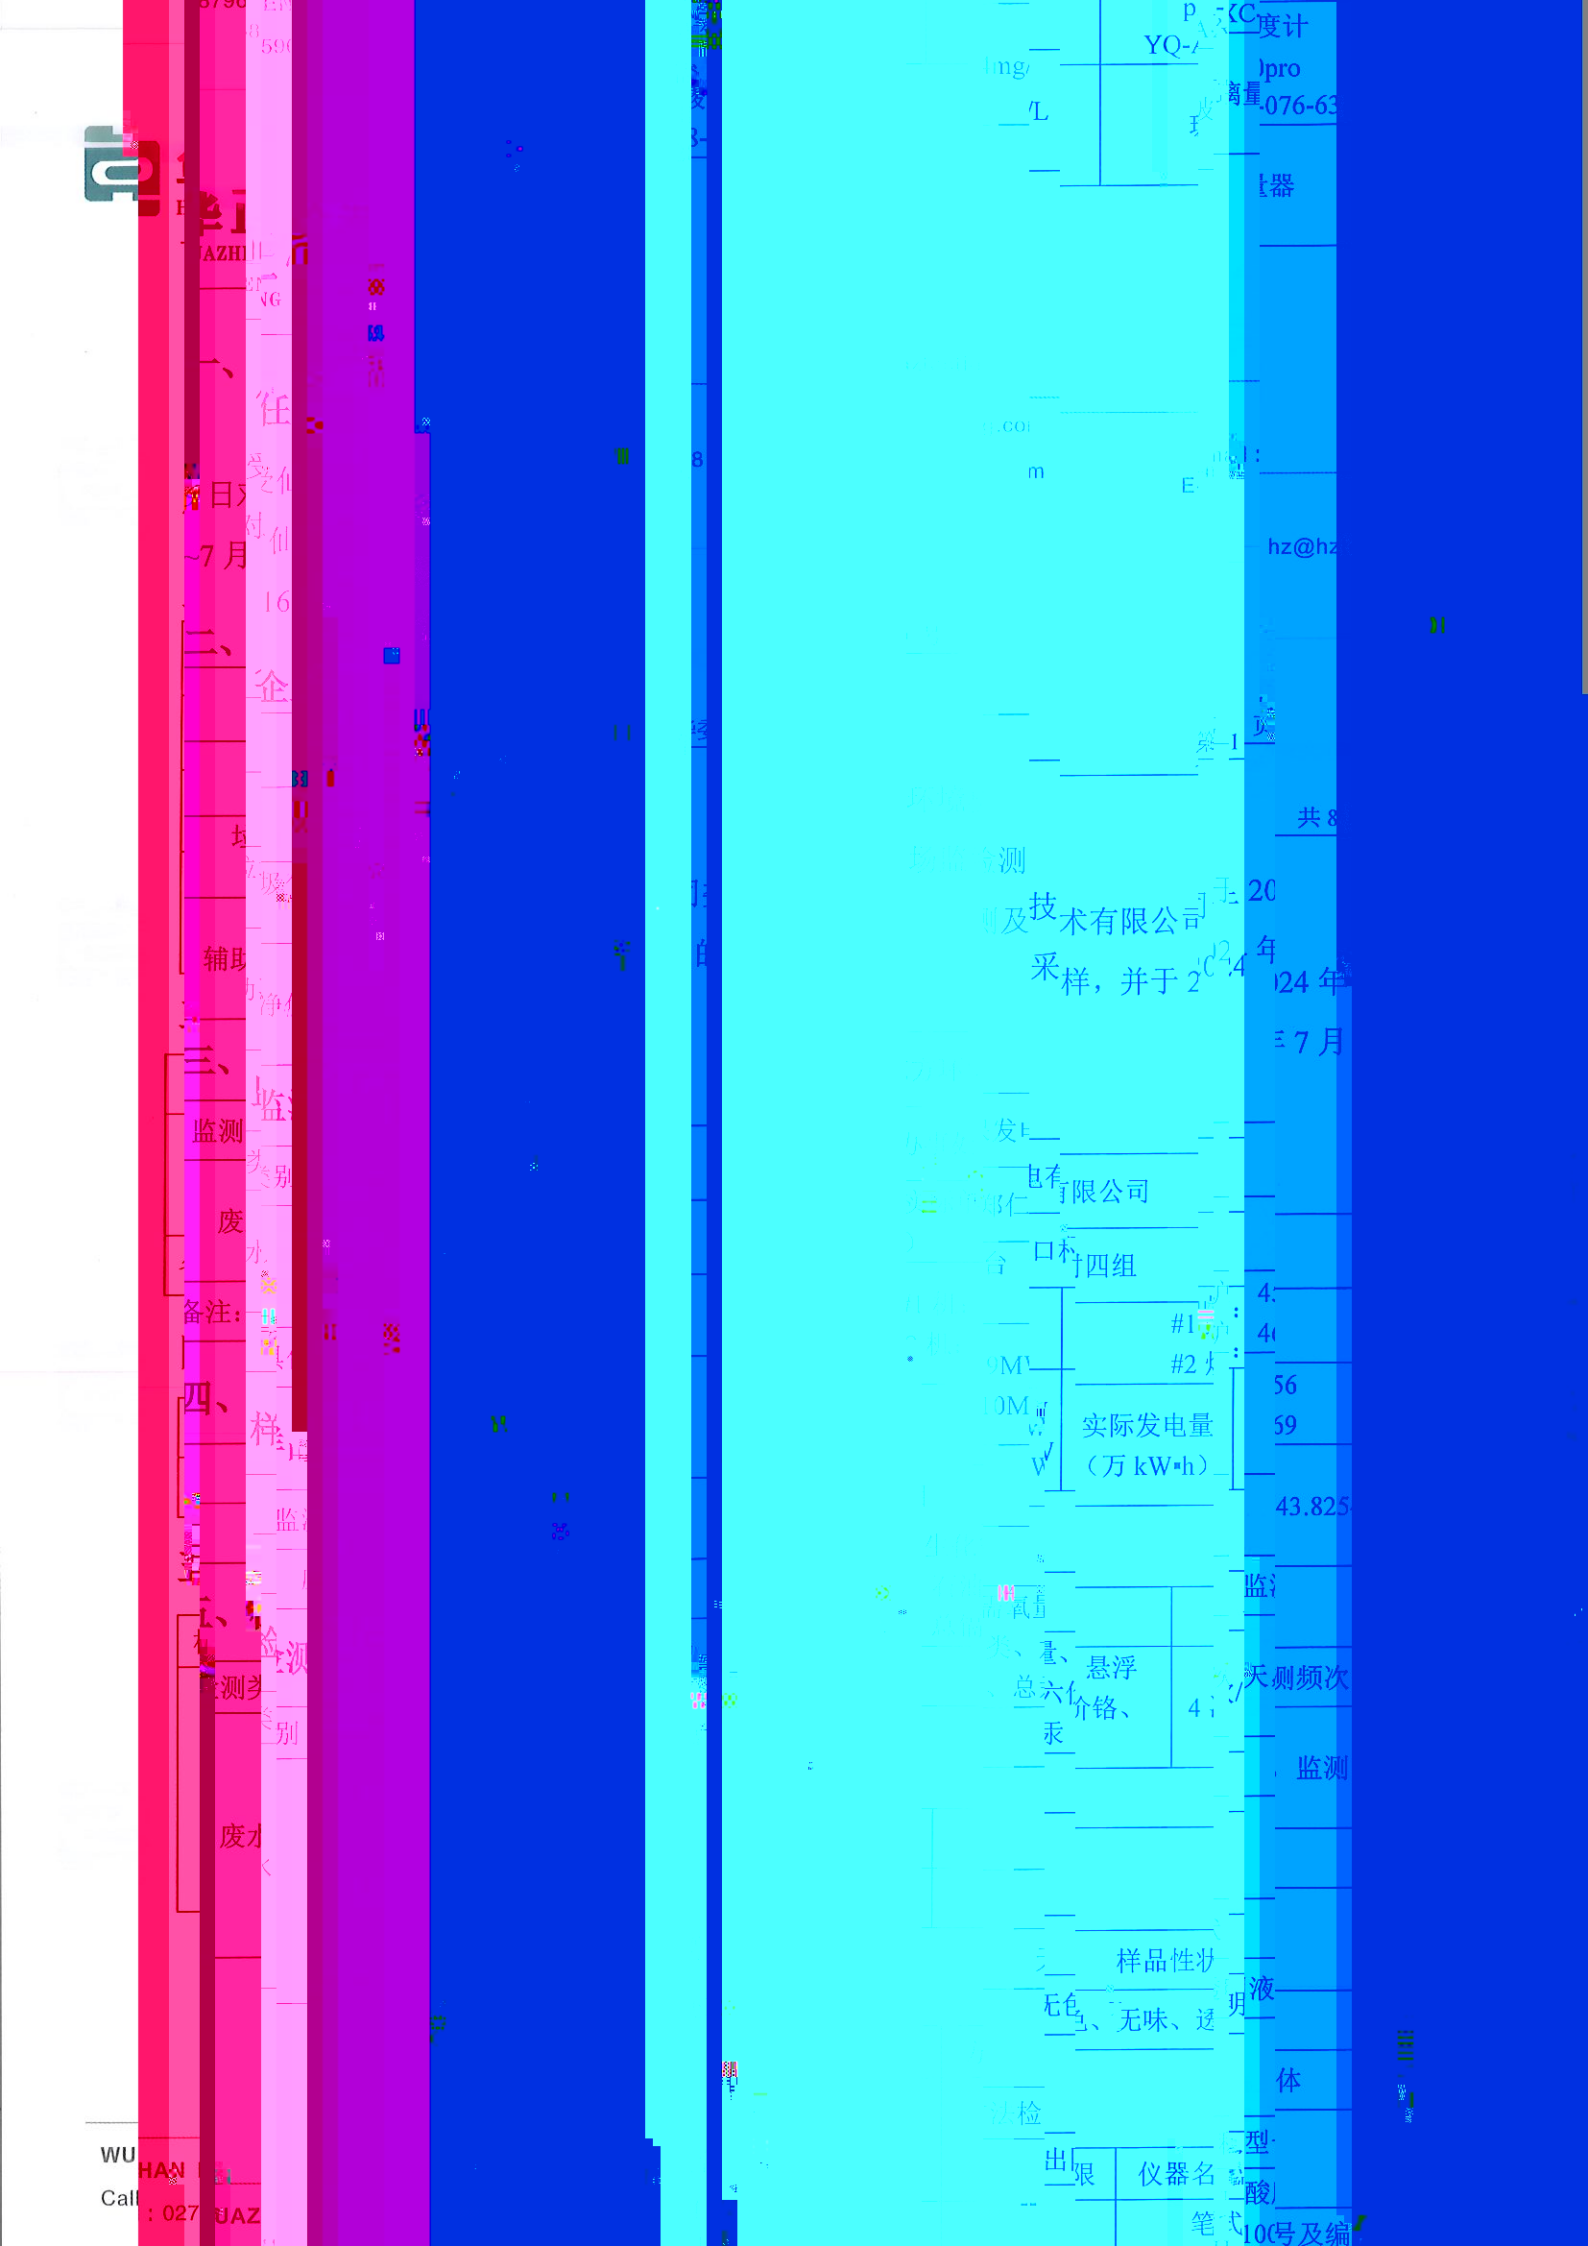

检测

废水

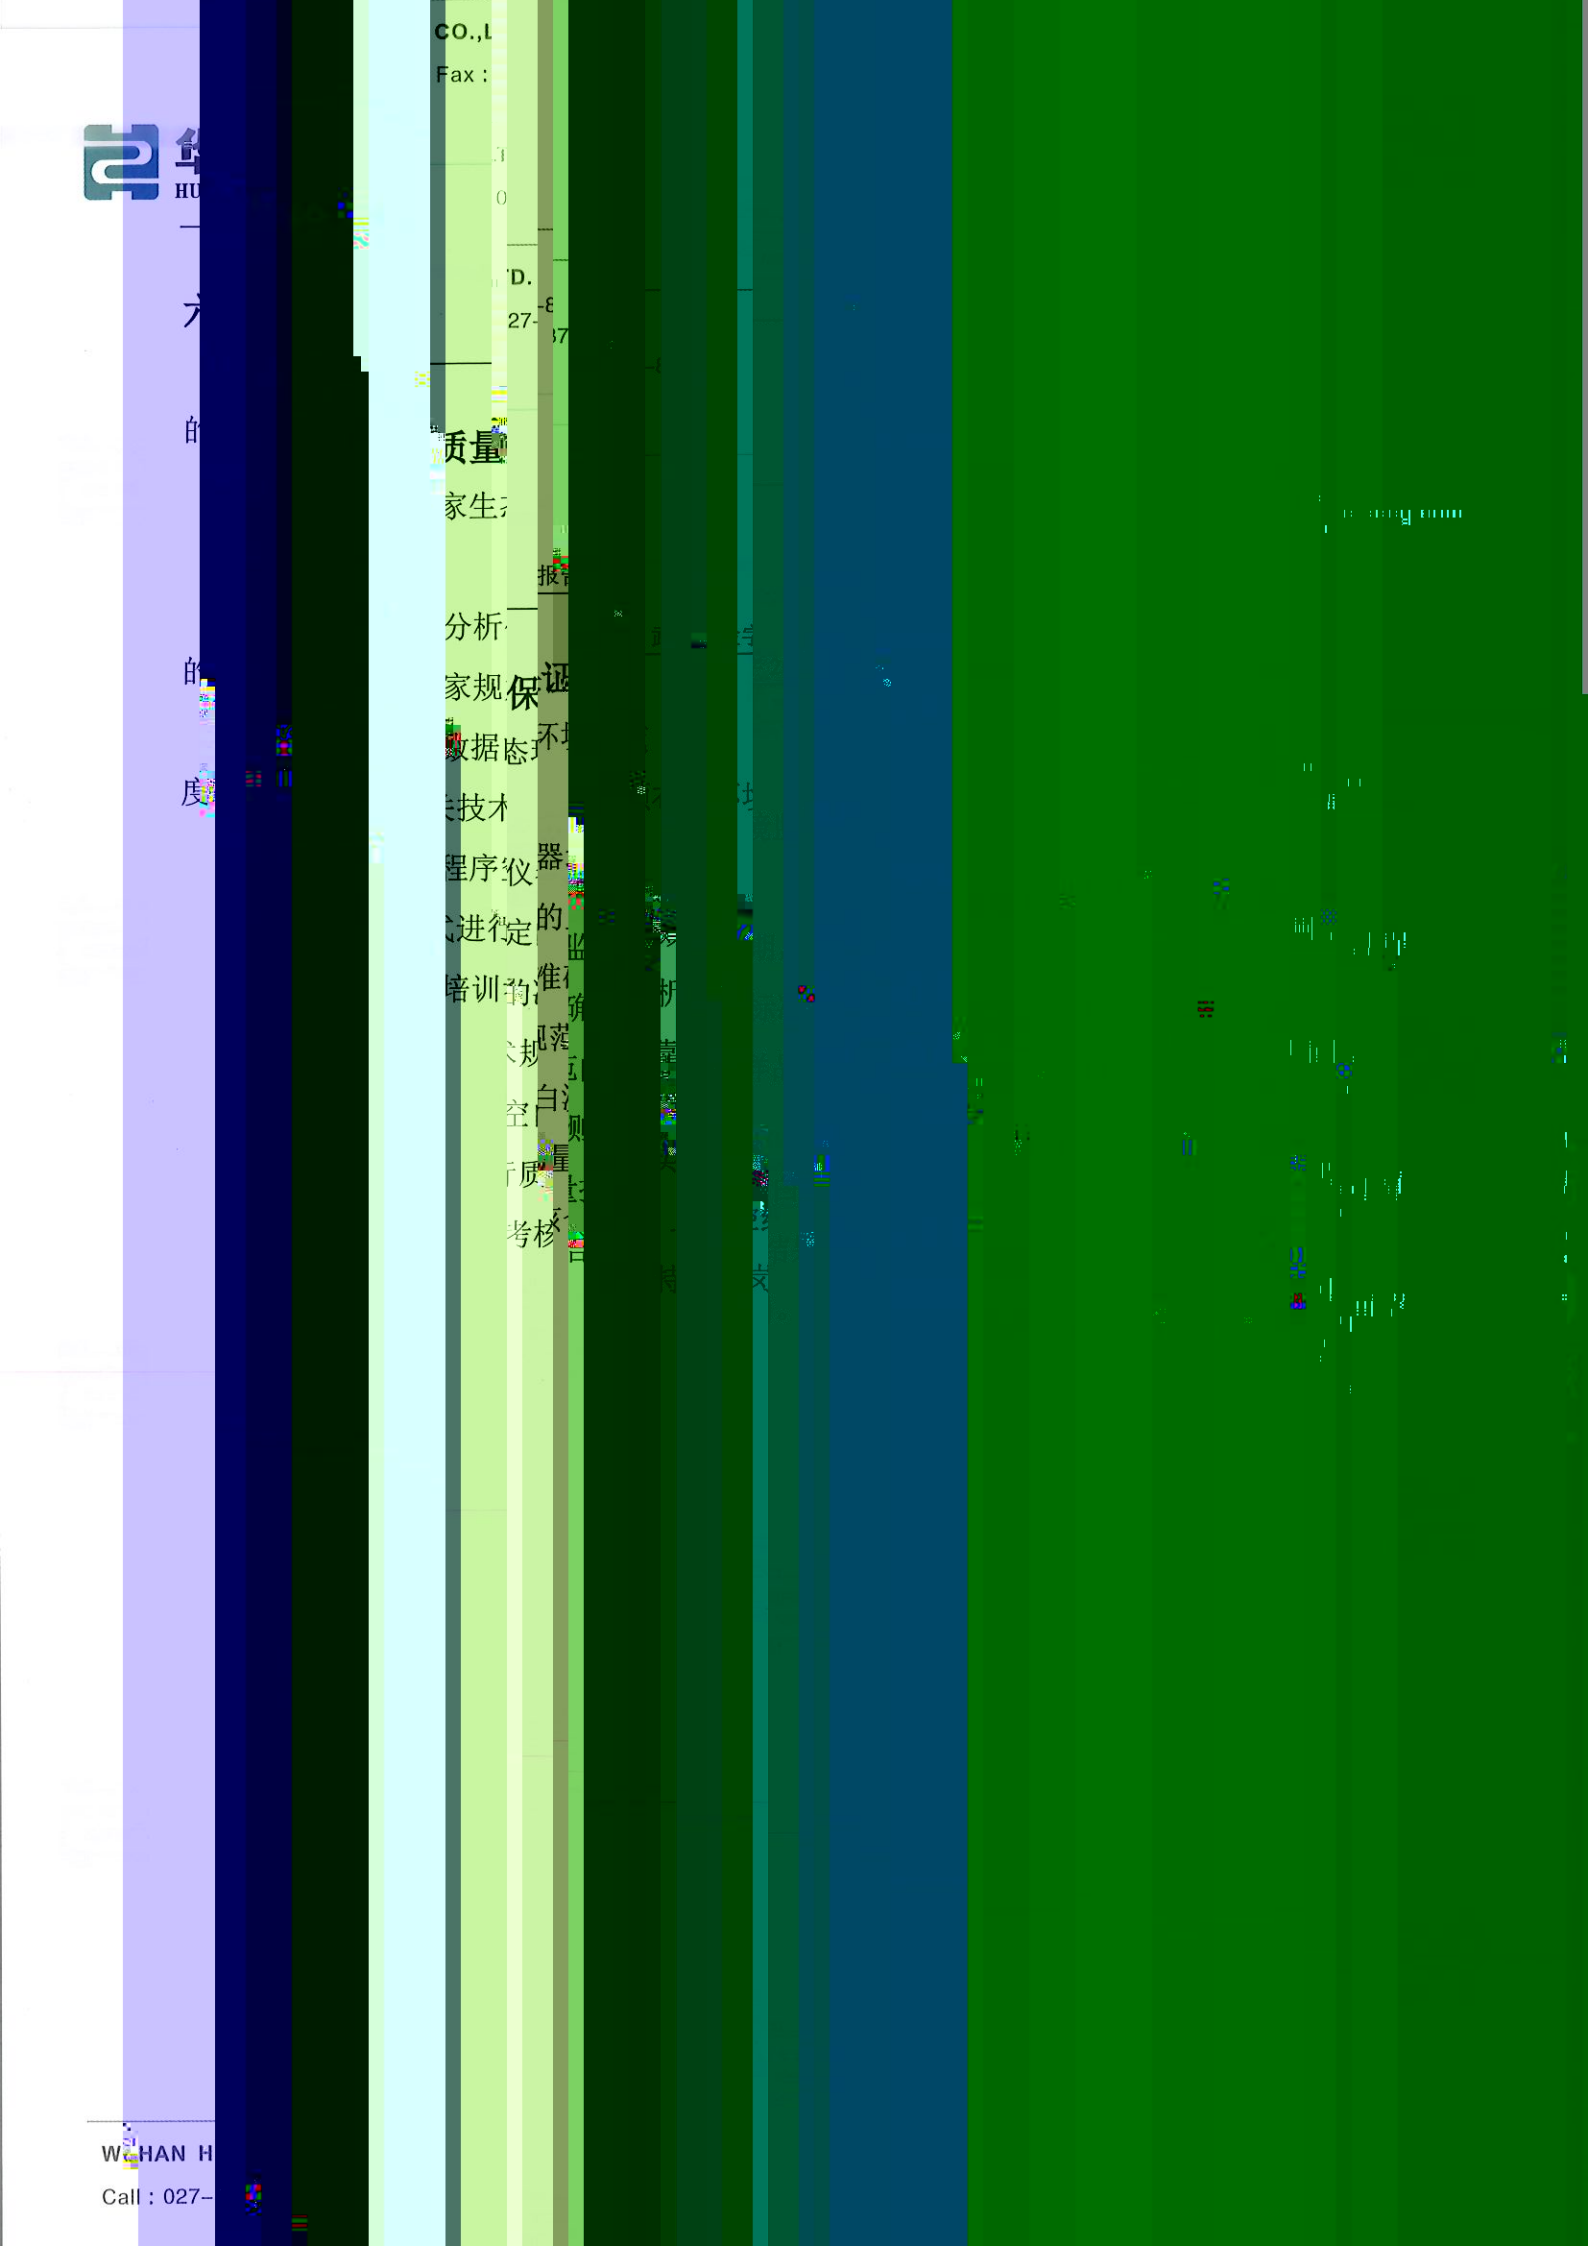

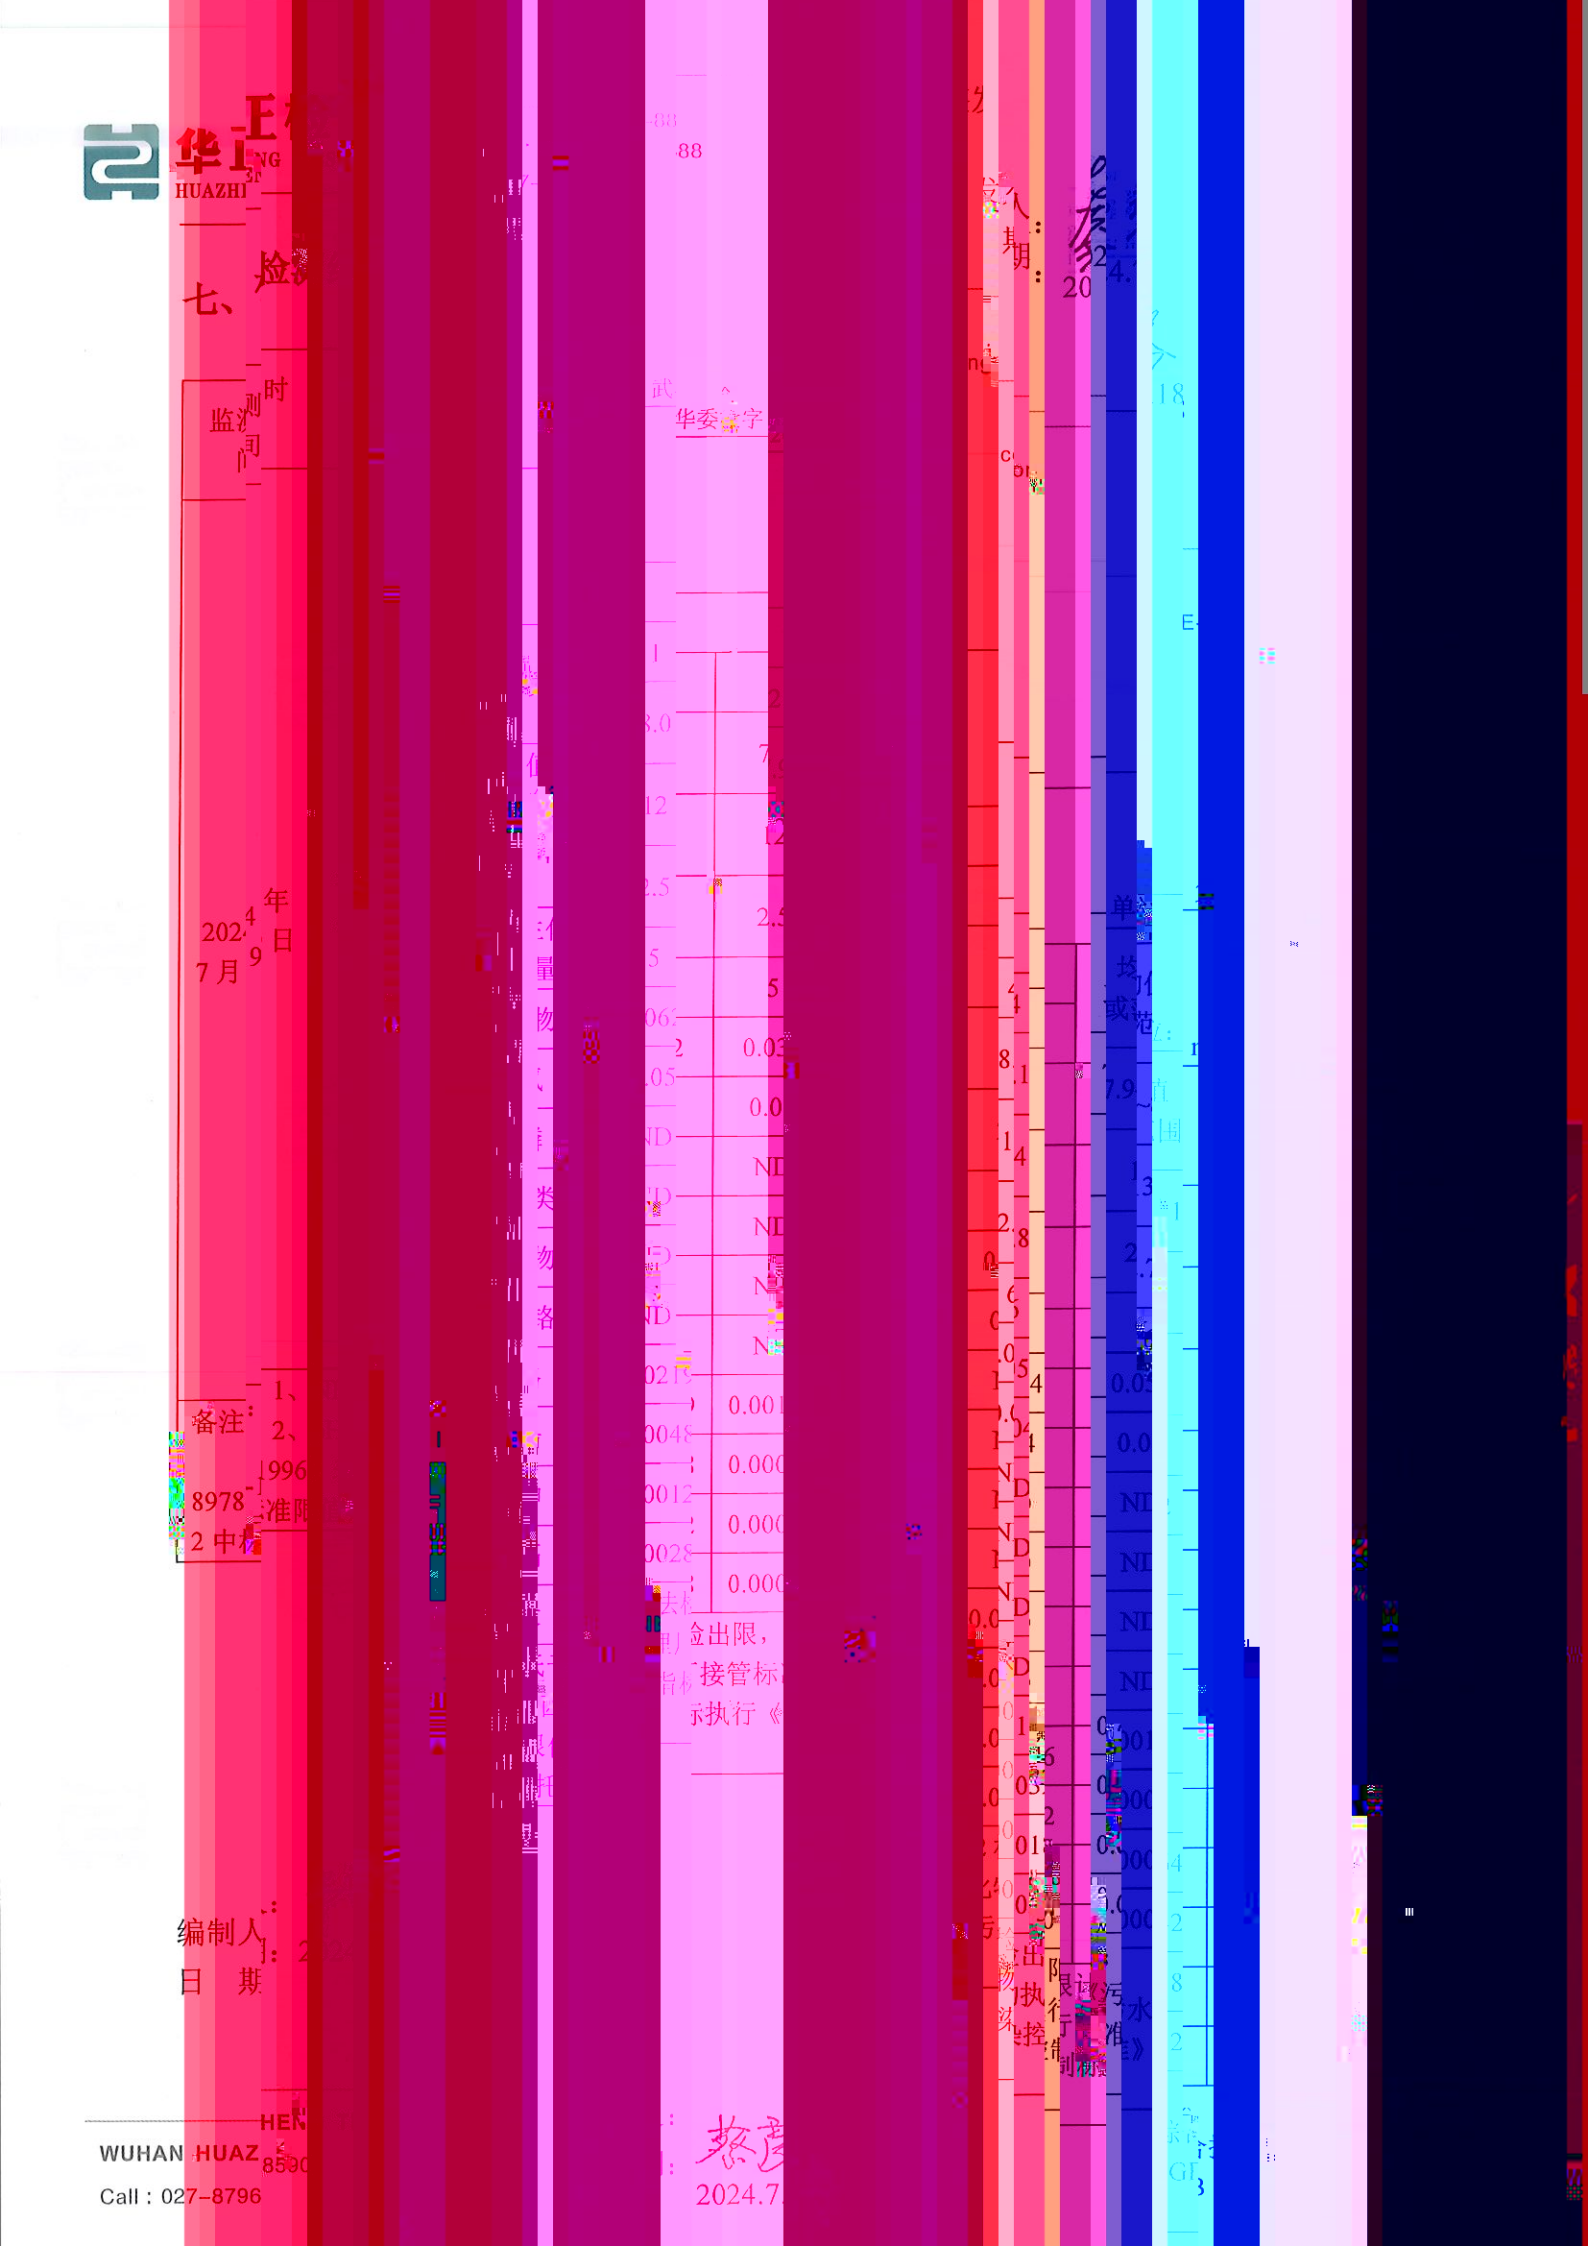

附

一览表

双样	平行
偏差	偏差
5%	≤
0%	≤
7%	≤
--	
0	≤
--	
--	
--	
--	
--	

以 1/2 检出


表

准值
±0.05
.40mg/L
0.40μg/L
2.5mg/L
.008mg/L
.025mg/L


一览表

差	允许相
	≤1 0
	≤1 0





WUHAN HUAZ
Call：027-8796

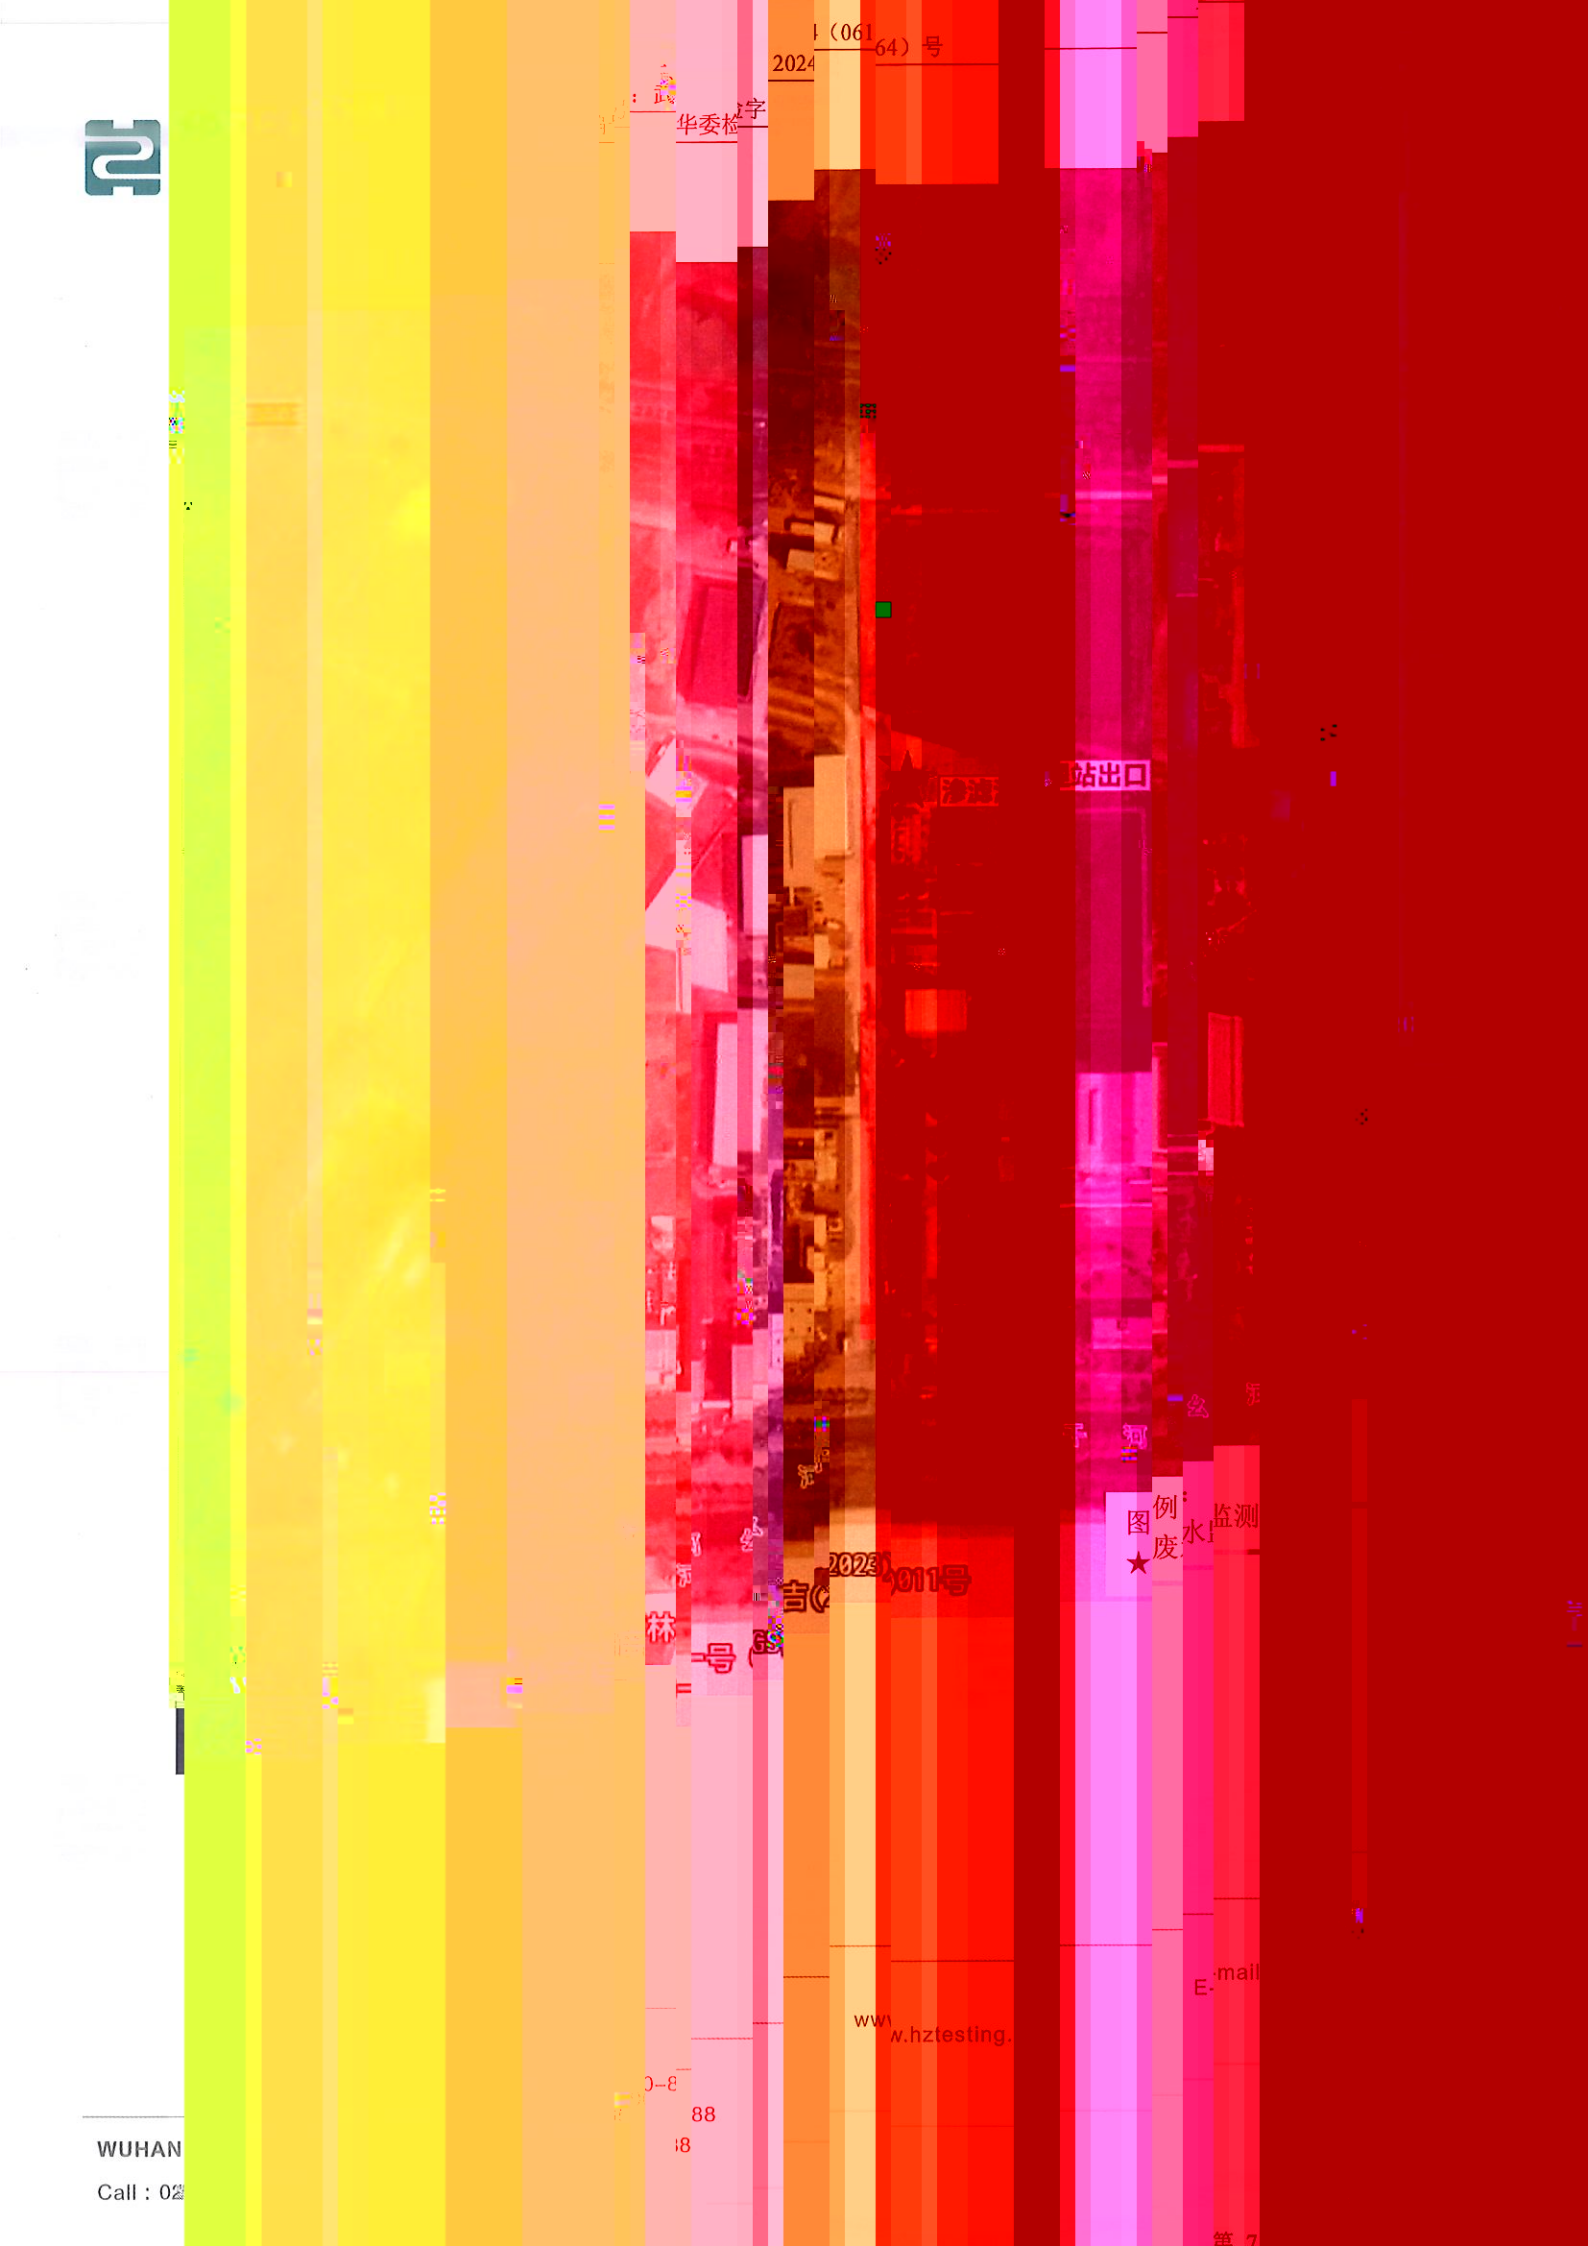

附

图 2：现场

