191412341355

正

本

思

检 告

Te ort

报告编号：2078Z

项目名称：鄱阳县绿[illegible]

运维单位：焚烧[illegible]

鄱[illegible]公司鄱阳县[illegible]

设备比对监[illegible]

技有限公司

（检[illegible]

[illegible]活垃[illegible]

[illegible]

[illegible]公司

江西[illegible]

JIANGXI TOPS D[illegible]OLOGY CO,LTD.

报告说明

(1) 本公司保证检测的公正和准确性，对委托单位所提供样品和技术资料保密。

(2) 根据客户的检测要求，本公司将对检测数据负责。样品的变化，本公司将不负检测因素导致的结果不确定度责任。

(3) 对本报告若有异议，应于收到报告之日起十日内向本公司提出，来函来电请注明报告期限为检测报告发出之日起十日。

(4) 本报告涂改无效，无本公司检验检测专用章及无资质认定标志CMA视为无效，无骑缝章无效。

(5) 如客户没有特别要求，样品超过样品保存期后将做废弃处置。

(6) 本报告仅对来样负责，对无法保存、复现的样品不受理申诉。

(7) 本报告数据仅针对此样品负责，检测余样依样品保存规定处置，对无法保存、复现的样品不受理申诉。

(8) 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

(9) 本报告不得用于公证或引用本报告，不得用于广告。

报告编

号

项

项

委

电

报

告

审

江西

报告

报告编号：TPSLY25[illegible]2

[illegible]-078Z

一、前言

克麦哪阳县绿色东方[illegible]再生能源公司位于江西省化氢、含克（北京）[illegible]器有限公司生产，可在线限公司一氧化碳等。2025年12月，鄱阳县昌控设备对鄱阳县绿色东方再生能源公司鄱阳县二、[illegible]各进行了比对监测，在此基础上编制完成

依据

64号；(1)《关于加强生活垃圾焚烧发电厂自动

(2)《固定污染源烟气

(3)《固定污染源废气（SO_2、NO_x、颗粒

修改单(4)《固定污染源排气一氧化碳和氯化氢

单；中颗粒物测定与气

(5)《固定污染源

(6)《固定污染源废气低浓度颗粒物的测

(7)《固定污染源废气二氧化硫的测定 定

(8)《固定污染源废气氮氧化物的测定 定

(9)《固定污染源废气一氧化碳的测定 定

排气中氯化氢的测定 硫

报告编号：

TPSLY2512078Z

三、 在线

根据《关 比对监测考核 自动监控 和监管执 号及《固定污 规范法 器比对考核指 于加强生活垃 氮自 动监测 技术 》（ 染源废气 一氧 烟气 在线监测 仪器比 对 检测项目标均需达到表 考核 指 表

项目		
颗粒物	准确度	排放浓度≤20 mg/m³时，相对误差为±15%；排放浓度＞20 mg/m³～100 mg/m³时，相对误差为±20%；排放浓度＞100 mg/m³～200 mg/m³时，相对误差为±15%；排放浓度＞200 mg/m³～500 mg/m³时，相对误差为±10%；排放浓度＞500 mg/m³时，相对误差为±5%。
二氧化硫	准确度	排放浓度≤50 mg/m³时，相对误差为±20%；排放浓度＞50 mg/m³～100 mg/m³时，相对误差为±15%；排放浓度＞100 mg/m³～200 mg/m³时，相对误差为±10%；排放浓度＞200 mg/m³～500 mg/m³时，相对误差为±5%。
氮氧化物	准确度	排放浓度≤50 mg/m³时，相对误差为±20%；排放浓度＞50 mg/m³～100 mg/m³时，相对误差为±15%；排放浓度＞100 mg/m³～200 mg/m³时，相对误差为±10%；排放浓度＞200 mg/m³～500 mg/m³时，相对误差为±5%。
一氧化碳	准确度	排放浓度≤20 mg/m³时，相对误差为±20%；排放浓度＞20 mg/m³～50 mg/m³时，相对误差为±15%；排放浓度＞50 mg/m³～100 mg/m³时，相对误差为±10%；排放浓度＞100 mg/m³～250 mg/m³时，相对误差为±5%。
烟气温度	准确度	绝对误差为±3℃。
烟气湿度	准确度	绝对误差为±2%。
烟气流速	准确度	烟气流速＞5 m/s时，相对误差为±5%；烟气流速≤5 m/s时，绝对误差为±0.25 m/s。
含氧量	准确度	烟气流速＞5 m/s时，相对误差为±10%；烟气流速≤5 m/s时，绝对误差为±0.5 m/s。
氯化氢	准确度	排放浓度≤10 mg/m³时，绝对误差为±4 mg/m³；排放浓度＞10 mg/m³～50 mg/m³时，相对误差为±40%；排放浓度＞50 mg/m³～100 mg/m³时，相对误差为±30%；排放浓度＞100 mg/m³～250 mg/m³时，相对误差为±25%。

报告编

四、

现场	
测	
仪	
CEMS	
颗粒物	
项	
浓	
时	
参比方	
CEM	
比对监	
绝对	
比对监	
相对	
技术	
绝对	
结	
所用仪	
电	

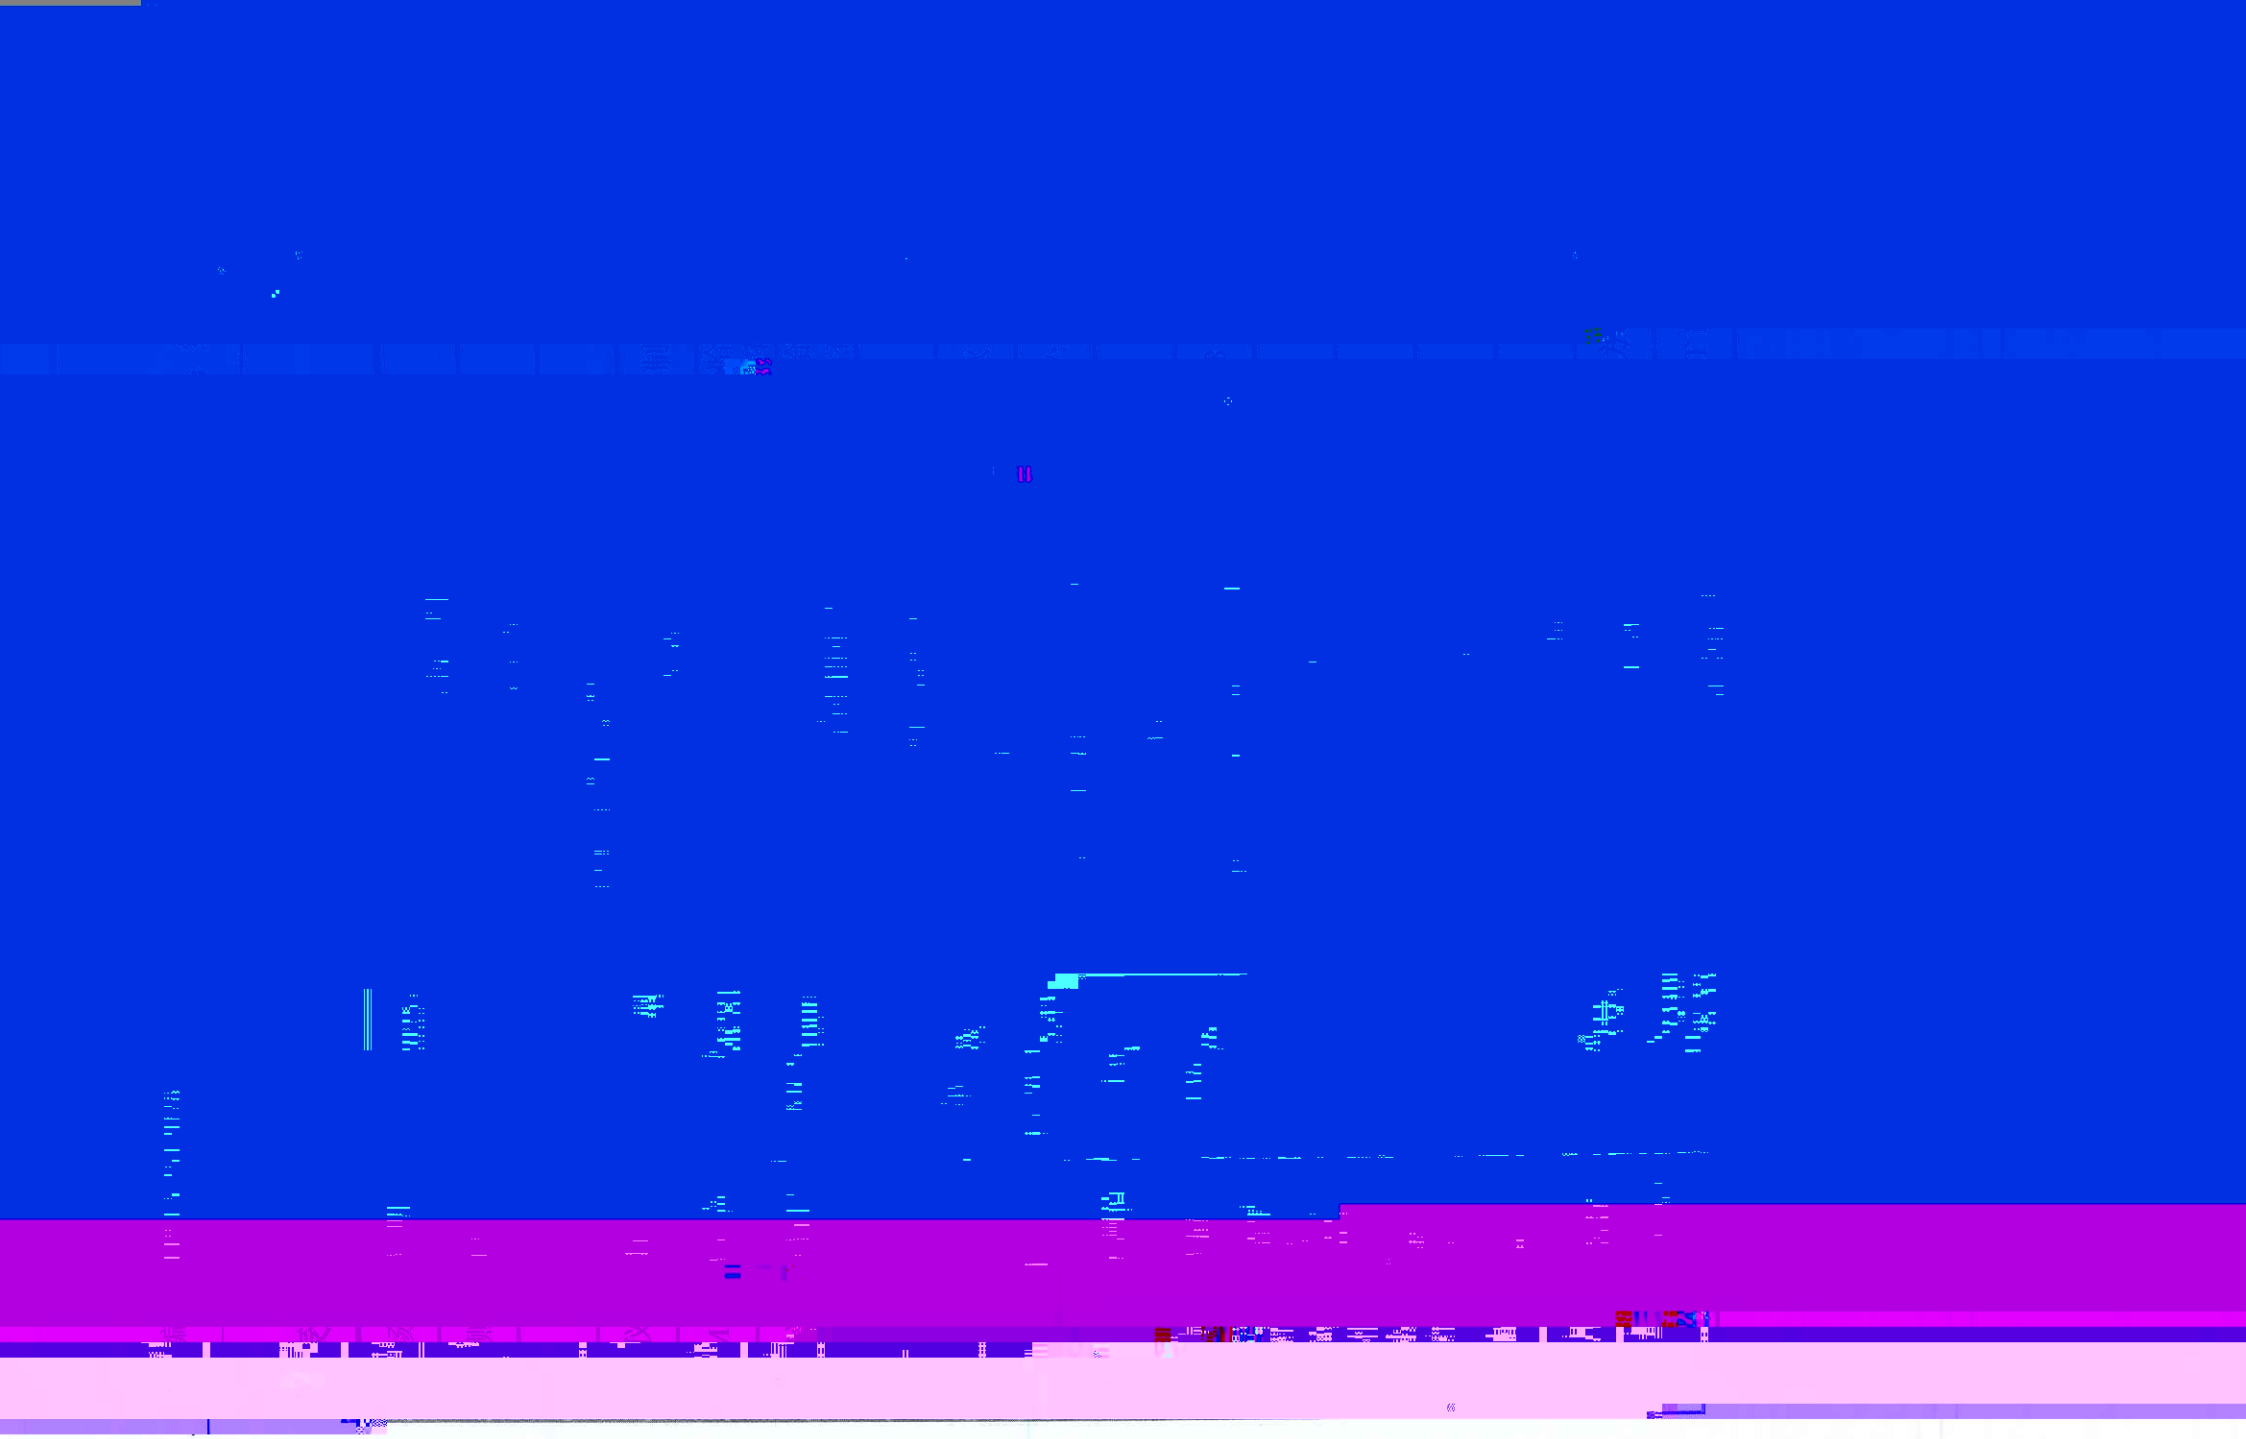

报告编

续表

现场

测

仪

CEMS

气流

烟

比方

CEM

对

绝

对

相

技

标

结

所用

大

(气

续表

现场[redacted]						
测[redacted]						
仪[redacted]						
CEMS[redacted]						
含湿量[redacted]						
项[redacted]						
次[redacted]						
时[redacted]						
参比方法[redacted]						
CEM[redacted]						
比对监[redacted] 绝对[redacted]						
比对监[redacted] 相对[redacted]						
技术[redacted] 相对[redacted]						
结果[redacted]						
所用仪[redacted]						
大流量[redacted] （气）						

制[redacted]

[redacted]克麦哈[redacted]单位

[redacted]器有[redacted]克（北京）仪

[redacted]克麦哈[redacted]有限公司

[redacted]器有[redacted]克（北京）仪

[redacted]有限公司

[redacted]第五次

[redacted]08~17:[redacted]

[redacted]31

[redacted]22.8

[redacted]23.23

第六次
17:35~17:58
24.0
24.50

方[redacted]

[redacted]去依据

[redacted]GB/T 1[redacted]

[redacted]6157-1996

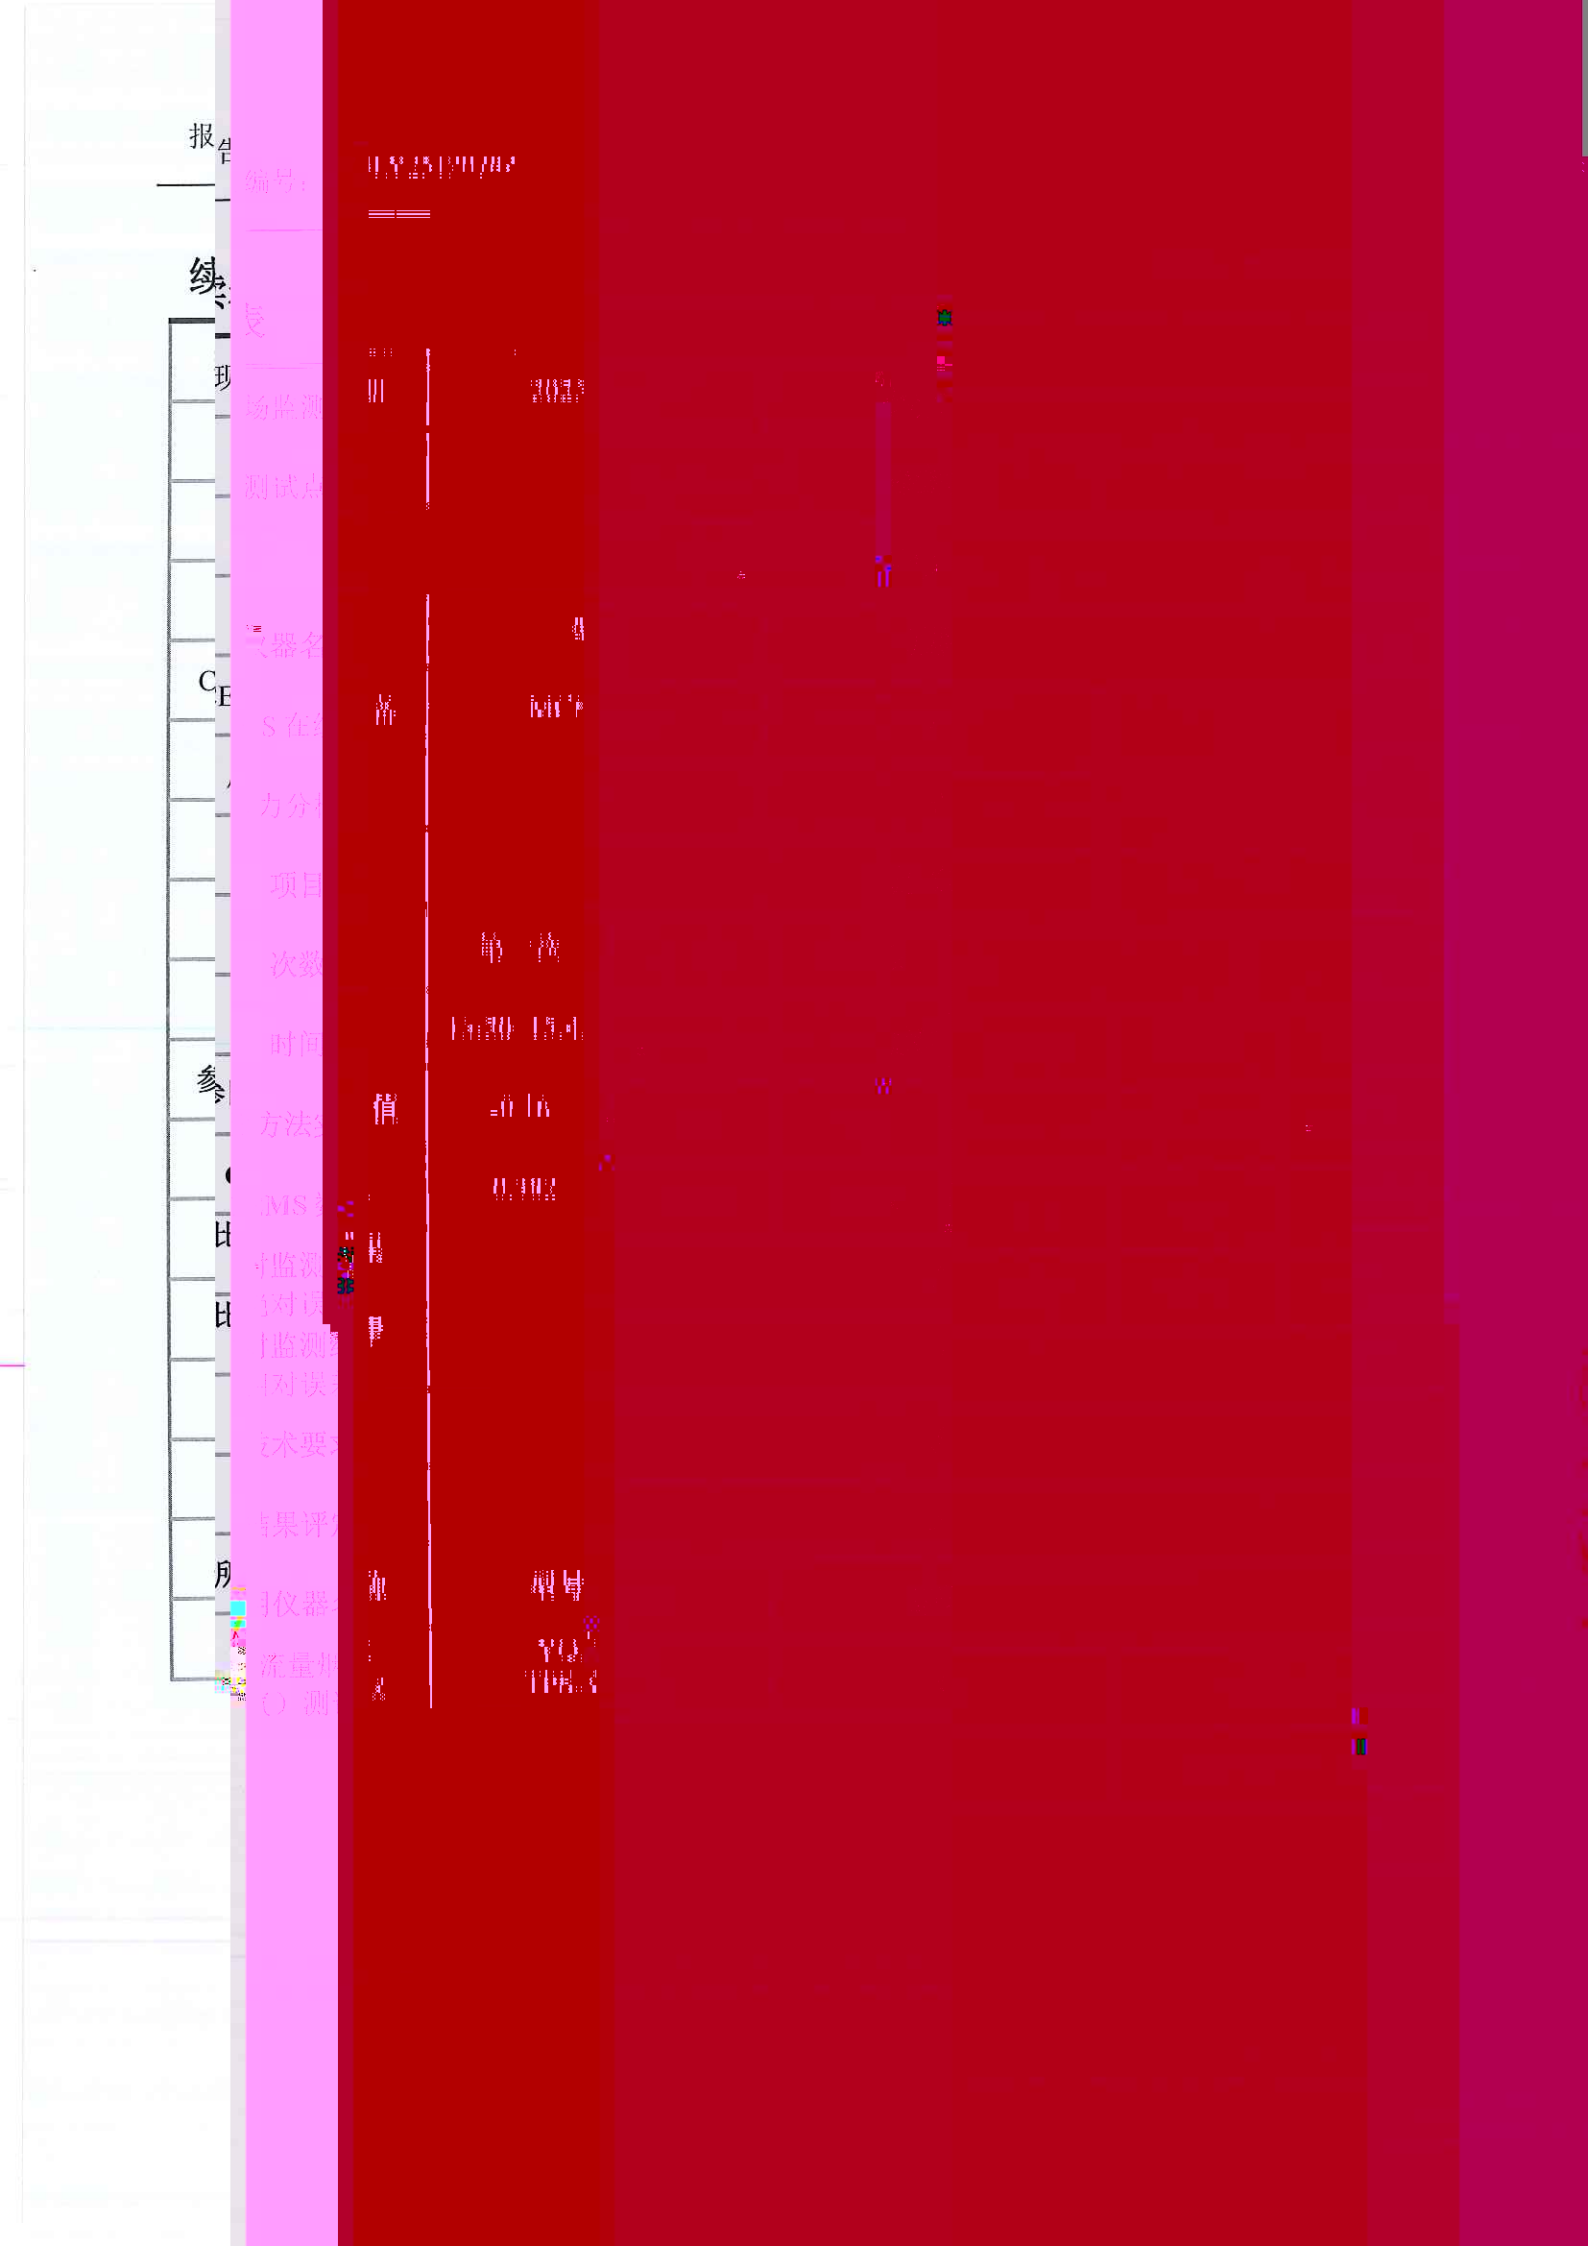

续表

现场	采样日期	2025-12-15				分析日期					/
污染源	工况	焚烧炉									
CEMS	设备名称	CEMS 主要仪器型号									
二氧化硫	分析仪器	型号				原理					制造单位
		MCS100FT-15855				/					西克麦哈克（北京）仪器有限公司
		MCS100FT-15855				高温傅立叶					西克麦哈克（北京）仪器有限公司
参比方	实测值	二氧化硫（mg/m³）									
		第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次	第九次	
CEMS		14:08~14:12	14:16~14:20	14:24~14:28	14:32~14:36	14:40~14:44	14:48~14:52	14:56~15:00	15:04~15:08	15:12~15:16	
比对	数值	12	10	92	40	80	33	5	83	28	
比对结果	结果	10.221	8.896	87.484	46.441	88.523	27.554	48.396	90.563	21.931	
绝对值差结果	差					-0.365					
结论	求差					/					
所用方法	定					≤17					
大流量测	名称					合格					
	型号（气）					原理					方法依据
	编号	YQ-TPS-03000-C-YQ-1-30				定电位电解法					HJ 57-2017

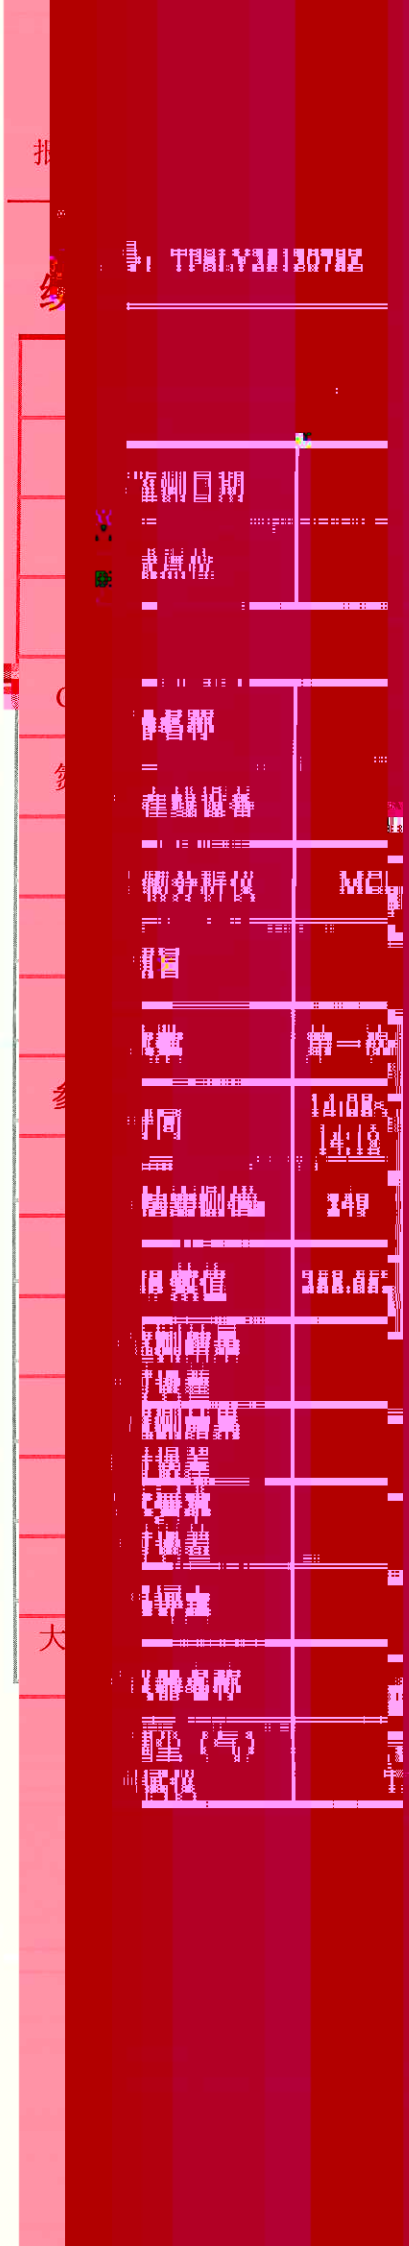

续表

现
CE
一氧
参比
C
比
比
所
大流量

报告

续

C
金
参
比
比
月
大流